



Untersuchung der Laborkenntnisse in der EU

Fehlerrate bei den beteiligten Laboren

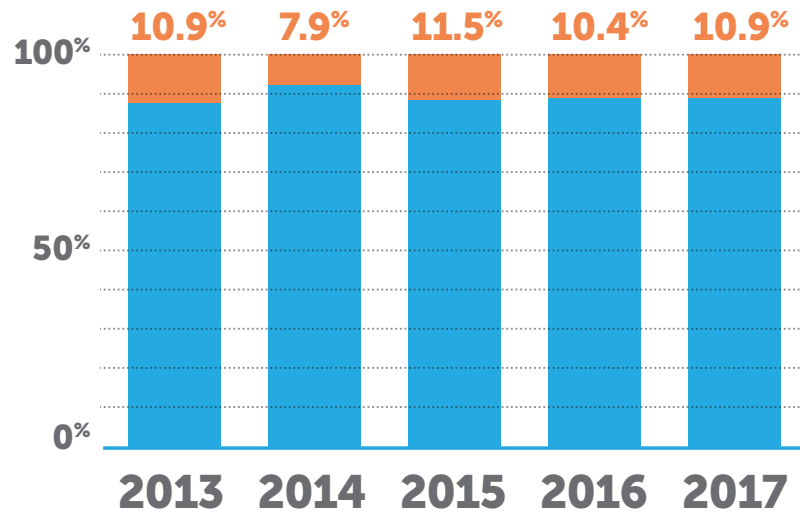

Schlüsselnummer: ■ Richtig ■ Falsch

Fehlerrate bezüglich Parameter (häufigste)

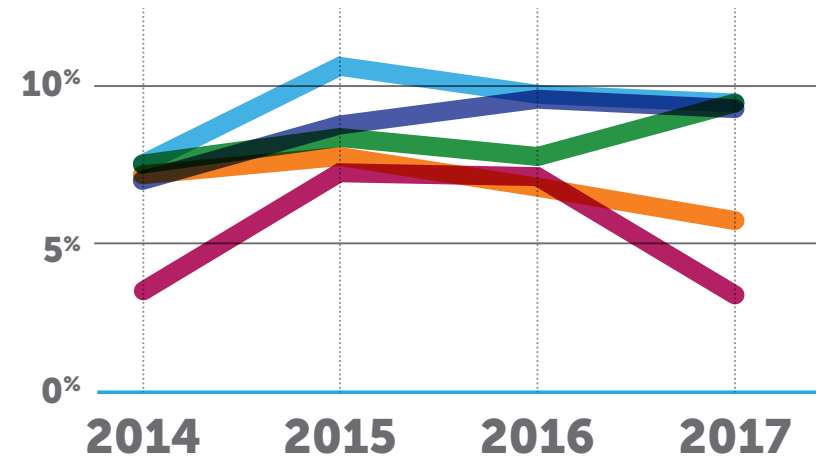

Schlüsselnummer:

■ Gesamtstickstoff ■ Gesamtphosphor
■ Nitrat ■ Ammonium ■ CSB

Source, University of Stuttgart, <http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/>



Be Right™